



III. OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA UŻYWANYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU – OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W GIŻYCKU.


L. p.	Nazwa ruchomości		Ilość szt. ltr.
	Dane i ocena stanu technicznego	Fot.	
1	Aparat do terapii ultradźwiękowej BTL 5710 Sono		1
Aparat 1-kanalowy do terapii ultradźwiękowej. Marka – BTL. Typ – BTL-5000. Model – BTL 5710 Sono. Rok produkcji – 2012. Zasilanie – 50-60 Hz, 230/115 V. Ekran – dotykowy, kolorowy 5,7”. Liczba głowic ultradźwiękowych podłączonych równocześnie – 2. 1-głowica – 5 cm², 1 i 3 MHz. 1-głowica – 1 cm², 1 i 3 MHz. Częstotliwość modułowa – 10-150 Hz. Max. natężenie w trybie ciągłym – 2 W/cm². Max. natężenie w trybie impulsowym - 3 W/cm². Aparat bez statywu jest kompletny i sprawny, serwisowany na bieżąco. Wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny dobry.			

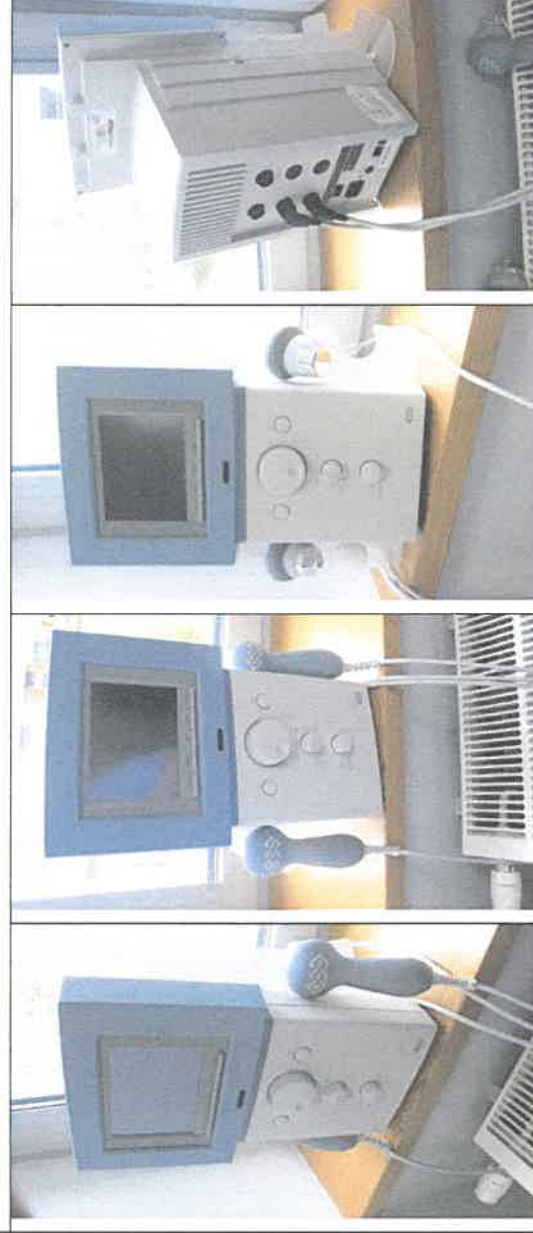


2	Aparat do krioterapii Metrum CryoFlex Cryo-T ELEPHANT	1
	Aparat do krioterapii miejscowej z dyszką sterowaną ręcznie. Marka – Metrum CryoFlex. Model – Cryo-T ELEPHANT. Rok produkcji – 2012. Numer seryjny – CTEH 116 AI. Zasilanie – 50 Hz, 230 V, 140 VA. Pojemność zbiornika czynnika chłodzącego (ciepłego azotu) – 35 ltr. Ciśnienie robocze – 0,018 MPa. Temperatura zimnego strumienia – do - 170°C. Aparat z wózkiem jest kompletny i sprawny, serwisowany na bieżąco. Wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny dobry.	
	 	
	 	
3	Katedra bicia szkokkich TECHNOMEX CORDOBA	1
	Katedra bicia szkokkich do natrysków ruchomych. Marka – TECHNOMEX. Typ – CORDOBA. Rok produkcji – 2012. Numer seryjny – H/1103/00116. Zasilanie – 50 Hz, 230 V, 1,1 kW. Ciśnienie robocze – 2,0 bar. Wydajność – 1 m³/35 min. Katedra bicia jest kompletna, częściowo niesprawna, wymaga kolejnego serwisu. Jedna z pomp nie uzyskuje ciśnienia, uszkodzony jest podłokietnik lewego bicia. Pozostałe zespoły wykazują zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny średni.	

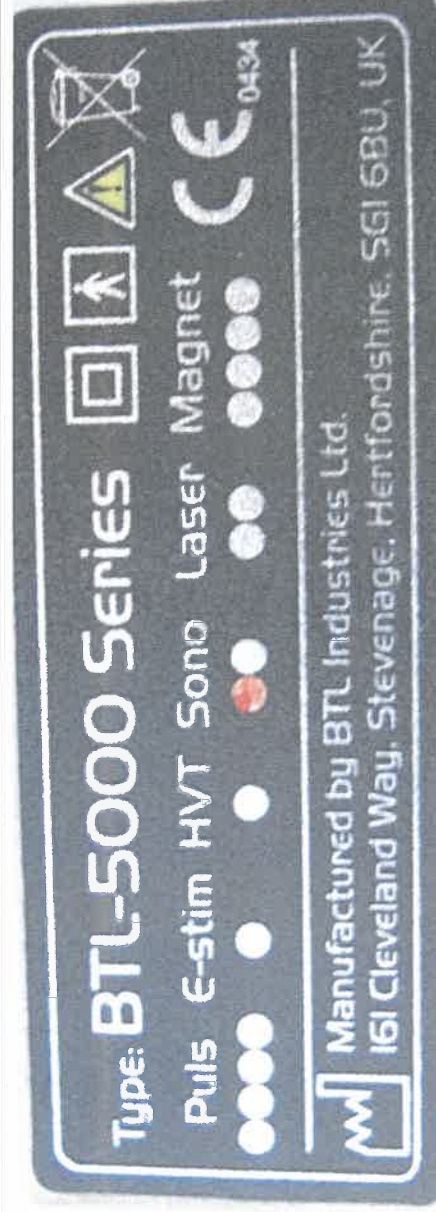


 PHU TECHNOMEX SP. Z O.O. ul. SZPARAGOWA 15, 44-141 GLIWICE, POLSKA tel/fax (+48) 231 66 60, 238-27-93, 401-03-50			
KATEDRA BICZY SZKOCKICH			
Typ	CORDOBA	Wymiary	-
SN	H/1103/00116	Wzrost	-
Wzrost	2012	Wzrost	-
			

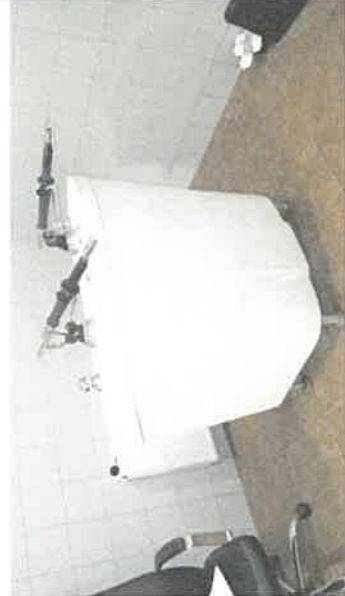


	
4	Stanowisko do zasilania wodą aparatu masażu wodnego Aquavibron MEDEN-INMED REF EKOPOMPA I z aparatem i węzami
	Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym aparatu masażu wodnego Aquavibron z aparatem, węzami i membranami. Marka – MEDEN-INMED. Typ – REF EKOPOMPA I. Rok produkcji – 2021. Numer seryjny – 06700-2021. Marka pompy – PEDROLLO. Typ pompy – PKm 60. Cisnienie robocze – 0,5-4,0 bar. Pojemność zbiornika – 7-10 ltr. Wydajność – 5-40 ltr/min. Zasilanie – 50 Hz, 220-230 V, 550 W. Stanowisko do zasilania wodą aparatu Aquavibron wraz z aparatem, węzami i membranami jest kompletne i sprawne, serwisowane na bieżąco. Wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny bardzo dobry.
	

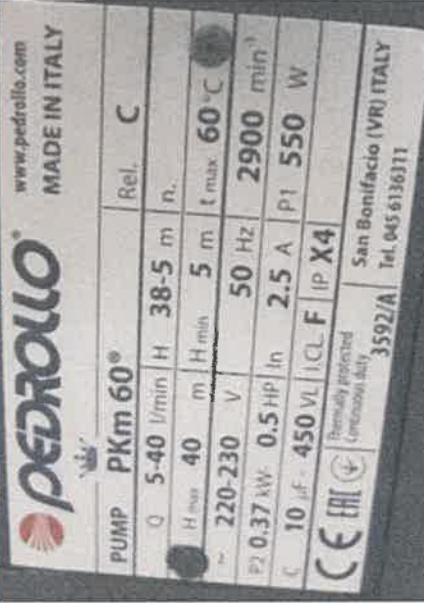			
			
			
5	Uniwersalny gabinet usprawniania lecniczego UGUL z osprzętem		1
Uniwersalny gabinet usprawniania lecniczego stanowi metalowa półotwarta klatka z osprzętem do ćwiczeń. Marka – UGUL. Rok produkcji – 2012. Ilość elementów klatki – 8. Wymiary 1-go elementu – 97 cm x 194 cm. Wymiary klatki - szerokość – 200 cm, długość – 200 cm, wysokość – 203 cm. Śruby montażowe kpl. z nakrętkami i podkładkami. Wykaz osprzętu: podwieszki skórzan – szt. 2 + 2 + 2 + 2, ciężarki skórzan – szt. 7, pasy i podwieszki tkaninowe – szt. 13, linki – szt. 12, trójkąt – szt. 1, haczyki – szt. 23, karabińczyki – szt. 10. Gabinet usprawniania lecniczego z osprzętem jest kompletny i sprawny, serwisowany na bieżąco. Klatka nie wykazuje zużycia, osprzęt wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny dobry.			

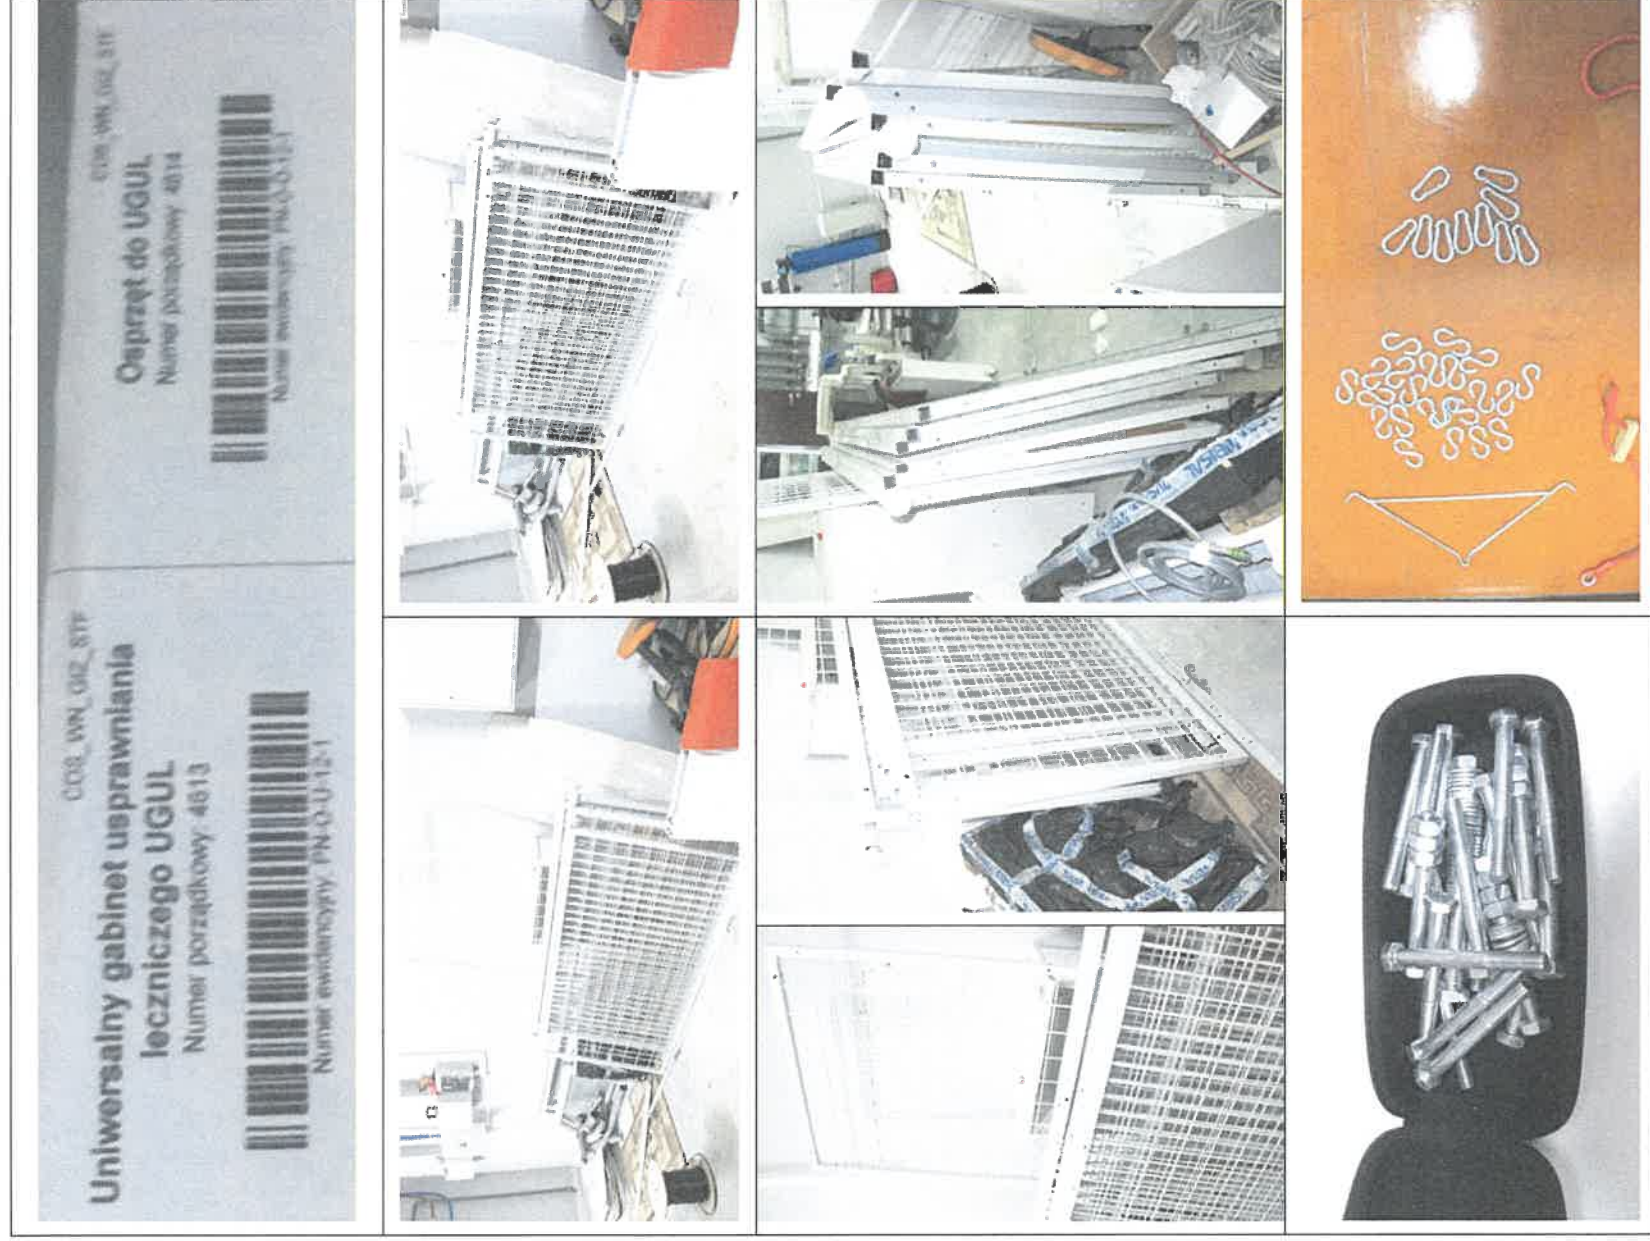

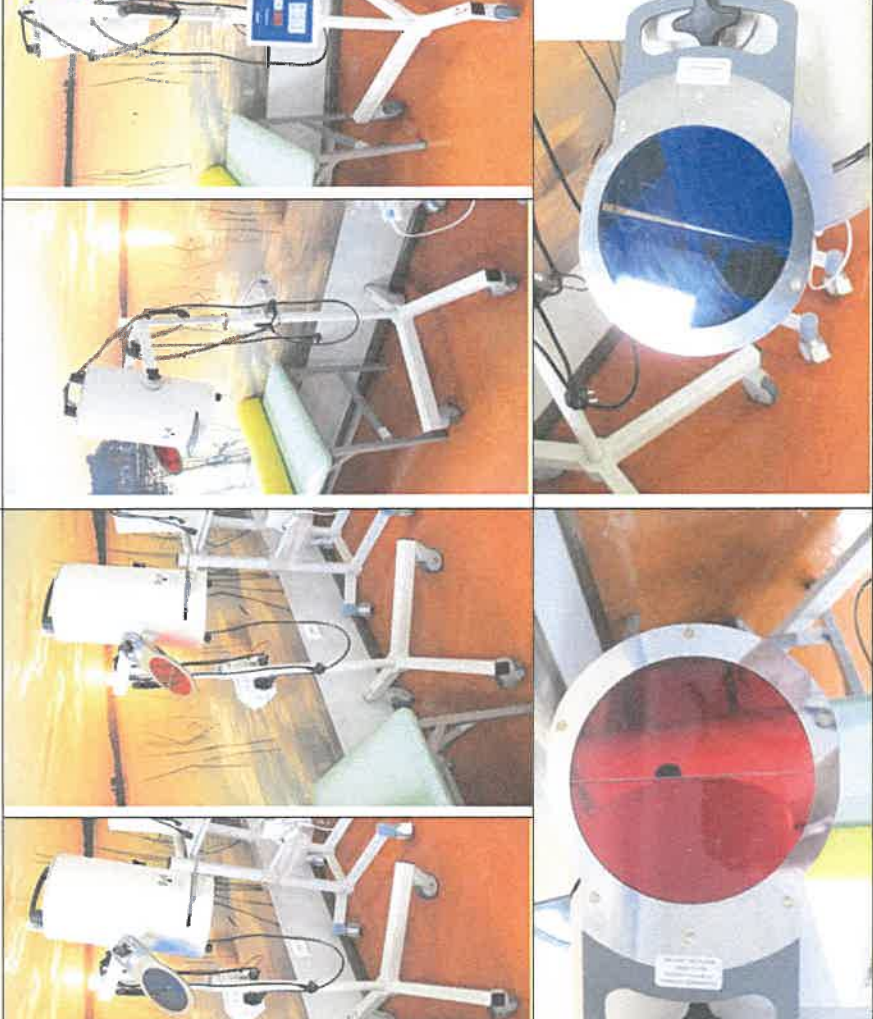

6	Lampa Sollux do terapii promieniowaniem podczerwonym ASTAR Lumina 3.4	1
	Lampa Sollux do terapii promieniowaniem podczerwonym. Marka – ASTAR. Model – Lumina. Wersja – 3.4. Rok produkcji – 2012. Nr seryjny – SL-36/06/12. Zasilanie – 50 Hz, 230 V, 450 W. Max. moc żarówki – 375 W. Lampa ze statywem jeżdżnym z wymiennymi filtrami: czerwonym i niebieskim jest kompletna i sprawna, serwisowa na bieżąco. Wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny dobry.	
	 ASTAR. Astar Strazacka 81, 43-382 Bielsko-Biała Polska / Poland tel. PL 33 829 24 40 tel. Int. +48 33 827 18 56 www.astar.eu WYPRODUKOWANO W POLSCE MADE IN POLAND  Lumina SN SL-36/06/12 VER 3.4 2012 IP20 230V~, 50Hz, max 450W 2xT3,15H250V	
		
7	Aparat do laseroterapii BTL 5110 Laser z wyposażeniem	1

Aparat 1-kanatowy do nieinwazyjnej terapii laserowej z wyposażeniem.

Marka – BTL. Typ – BTL-5000. Model – BTL 5110 Laser.

Rok produkcji – 2012.

Nr seryjny – 038—B-00559.

Zasilanie – 50-60 Hz, 230/115 V.

Ekran – dotykowy, kolorowy 5,7”.

Liczba sond laserowych podłączonych równocześnie – 2.

Wyposażenie:

- sonda laserowa prysznicowa - 800 mW, .


- 3 sondy punktowe – 50 mW, 100 mW, 400 mW.

Częstotliwość – 0-10000 Hz.

Dawka w trybie ciągłym i impulsowym – 0,1-100 J/cm².

Aparat z wyposażeniem i stolikiem na statywie jezdny jest kompletny i sprawny, serwisowany na bieżąco.

Wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny dobry.

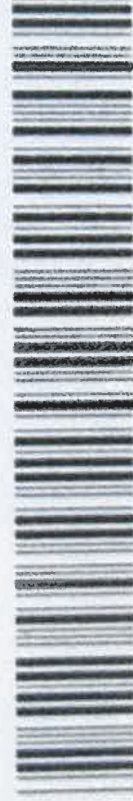

SN

038--B-00559

V100
04-2012



		
		
		
		
8	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa TECHNOMEX 1115E	1

Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa.

Marka – TECHNOMEX. Typ – 1115E.

Rok produkcji – 2012.

Numer seryjny – H/1203/0114.

Zasilanie – 50 Hz, 230 V, 1,1 kW.

Pojemność użytkowa – 70/220 ltr.

Wanna do masażu wirowego wyposażona w stopień do wanny jest kompletna i sprawna, serwisowana na bieżąco. Wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny dobry.


P H U TECHNOMEX SP. Z O. O.
ul. SZPARAGOWA 15, 44-141 GLIWICE, POLSKA
tel/fax (+48) 231-66-60, 238-27-93, 401-03-00

WANNY DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA

TYP	1115E	NAPIĘCIE	~230 V	
SM	H/1203/0114	CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 HZ	
MOC PROJEKCYJNA	2012	MOC	1.1 kW	

KLASA OCHRONNOŚCI I IP X5 CE

1187

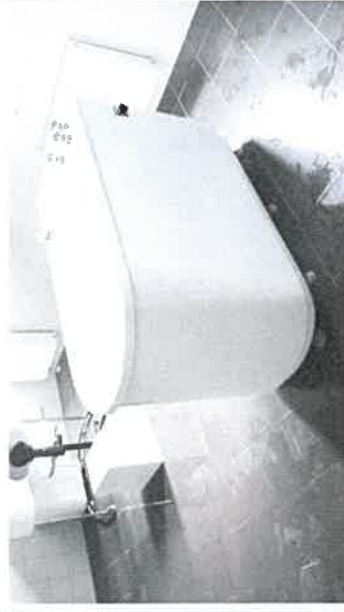

9	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych TECHNOMEX CASTILLO																	
Wanna do masażu wirowego kończyn górnych. Marka – TECHNOMEX. Typ – CASTILLO. Rok produkcji – 2012. Numer seryjny – H/1205/0207. Zasilanie – 50 Hz, 230 V, 1,1 kW. Pojemność użytkowa – 20 ltr. Wanna do masażu wirowego jest kompletna i sprawna, serwisowana na bieżąco. Wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny dobry.																		
PHU TECHNOMEX SP. Z O. O. ul. SZCZĘKOCZKA 16, 44-141 GLIWICE, POLSKA tel. fax (+48) 231-66-60, 238-27-93, 401-03-50 <table><tr><td colspan="4">WANNY DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH</td></tr><tr><td>Typ</td><td>CASTILLO</td><td>Napięcie</td><td>~230 V</td></tr><tr><td>Seria</td><td>H/1205/0207</td><td>Charakterystyka</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>Rok produkcji</td><td>2012</td><td>Moc</td><td>1.1 kW</td></tr></table> KLASA OCHRONNOŚCI I II° NS CE_{EMF} ★			WANNY DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH				Typ	CASTILLO	Napięcie	~230 V	Seria	H/1205/0207	Charakterystyka	50 Hz	Rok produkcji	2012	Moc	1.1 kW
WANNY DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH																		
Typ	CASTILLO	Napięcie	~230 V															
Seria	H/1205/0207	Charakterystyka	50 Hz															
Rok produkcji	2012	Moc	1.1 kW															



10	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych TECHNOMEX PIZARRO B	1
-----------	---	----------

Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych, stóp i podudzi.

Marka – TECHNOMEX. Typ – PIZARRO B.

Rok produkcji – 2012.



Numer seryjny – H/1204/0180.

Zasilanie – 50 Hz, 230 V, 1,1 kW.

Pojemność użytkowa - 75 ltr.

Wanna do masażu wirowego jest kompletna i sprawna, serwisowana na bieżąco.
Wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny dobry.

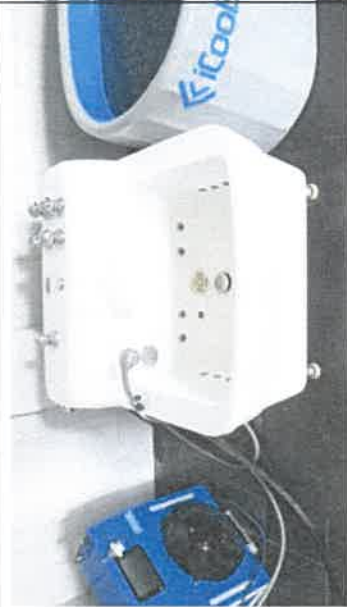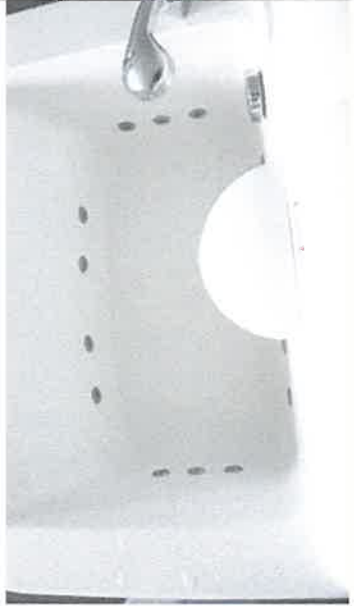

		
		
		
11	Urządzenie do chłodzenia wody w basenach dmuchanych jedno/dwu osobowych (bez basenu i pompki obiegowej) iCoolSport	1
Urządzenie do chłodzenia wody w basenach dmuchanych jedno/dwu osobowych (bez basenu i pompki obiegowej). Marka – iCoolSport. Symbol – IC998205. Rok produkcji – 2015. Do basenów o pojemności max. – 500 ltr. Zasilanie – 50-60 Hz, 210-240 V, 2000 W. Urządzenie do chłodzenia wody w basenach jest kompletne i sprawne, serwisowane na bieżąco. Wykazuje zużycie wynikające z okresu użytkowania. Stan techniczny dobry.		



Data i podpis Rzeczoznawcy:
05.05.2025 r.

inż. Roman Borkowski
RZECZOZNAWCA SDR
Nr uprawnień 1/CL/11
w specjalnościach
maszyn, urządzeń, wyposażenie
i środki transportu